ORA I TUOI PAZIENTI POSSONO

SENZA PUNGERSI[1]

GRAZIE ALL'ULTIMO AGGIORNAMENTO

L'ACCURATEZZA MIGLIORE DI SEMPRE*

DEL SISTEMA FREESTYLE LIBRE

- **Anche nell'intervallo basso del glucosio [2,3]**
- **Senza puntura del dito[1]**

FreeStyle LibreLink

life. to the fullest.

Abbott

* Rispetto al precedente aggiornamento del sistema FreeStyle Libre.

[1] La scansione del sensore non richiede l'uso di lancette pungidito. Il test tramite puntura del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi. [2] Scheda dati prestazioni sistema FreeStyle Libre. [3] Dati in archivio, Abbott Diabetes Care, Inc.

ACCURATEZZA COMPLESSIVA NEGLI ADULTI

Accuratezza migliore di sempre del sistema FreeStyle Libre, senza puntura del dito[1,2,3]

MARD complessiva[2] Più bassa è la MARD, più accurati sono i risultati	**9.2%**
% entro ±20 mg/dL/20%[2]	**93.2%**
% rientrante nelle Zone A e B della Consensus Error Grid[3]	**99.9%**

Consensus Error Grid per il sistema FreeStyle Libre rispetto al riferimento

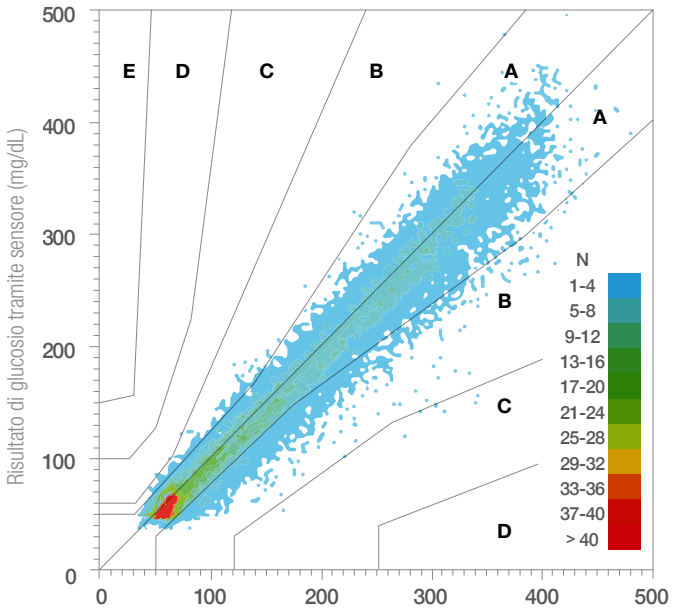

FreeStyle LibreLink

Nuovo aggiornamento dell'App FreeStyle LibreLink - senza puntura del dito[1] e senza calibrazione da parte dell'utilizzatore

Tutti i valori vs. Yellow Springs Instruments (YSI) MARD= Differenza Relativa Assoluta Media

[1] Il test tramite puntura del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi.

[2] Scheda dati prestazioni sistema FreeStyle Libre.

[3] Dati in archivio, Abbott Diabetes Care, Inc.

ACCURATEZZA GLUCOSIO BASSO ADULTI

Non è più necessario confermare le letture tramite puntura del dito nell'intervallo di glucosio basso[1]

Intervallo di glucosio basso

54-69 mg/dL

94.2%

% entro ±20 mg/dl

Intervallo di glucosio molto basso

<54 mg/dL

93.7%

% entro ±20 mg/dl

FreeStyle LibreLink

Non è necessario ricorrere alla puntura del dito anche quando il glucosio è basso, in calo o in rapida evoluzione[2]

Tutti i valori vs. Yellow Springs Instruments (YSI)

[1] Dati in archivio, Abbott Diabetes Care, Inc. [2] Il test tramite puntura del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi.

ACCURATEZZA COMPLESSIVA PEDIATRICA

Accuratezza per i pazienti di 4-17 anni per 14 giorni senza calibrazione con puntura del dito[1]

MARD complessiva[2] Più bassa è la MARD, più accurati sono i risultati	**9.7%**
% entro ±20 mg/dL/20%[2]	**91.6%**
% rientrante nelle Zone A e B della Consensus Error Grid[2]	**100%**

Consensus Error Grid per il sistema FreeStyle Libre rispetto al riferimento

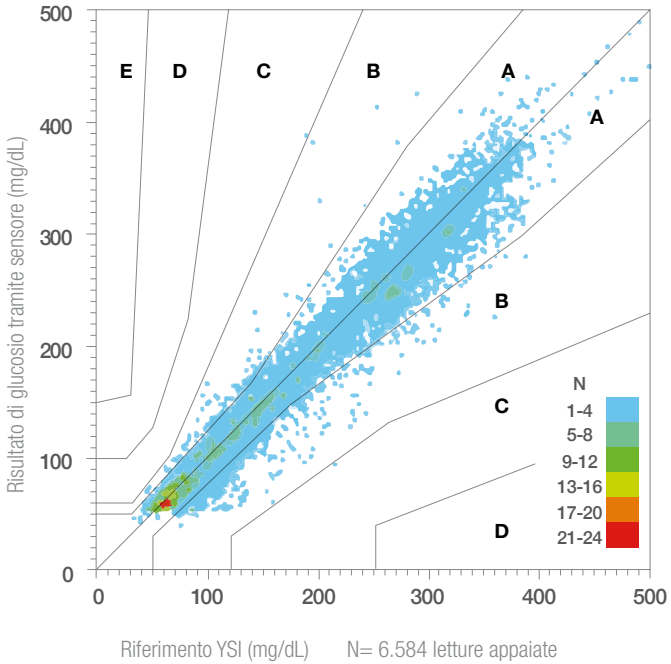

N= 6.584 letture appaiate

FreeStyle LibreLink

Tutti i valori vs. Yellow Springs Instruments (YSI) MARD= Differenza Relativa Assoluta Media

[1] Il test tramite puntura del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi.

[2] Dati in archivio, Abbott Diabetes Care, Inc.

ACCURATEZZA PEDIATRICA NELL'INTERVALLO BASSO

Non è più necessario confermare le letture tramite puntura del dito nell'intervallo di glucosio basso[1]

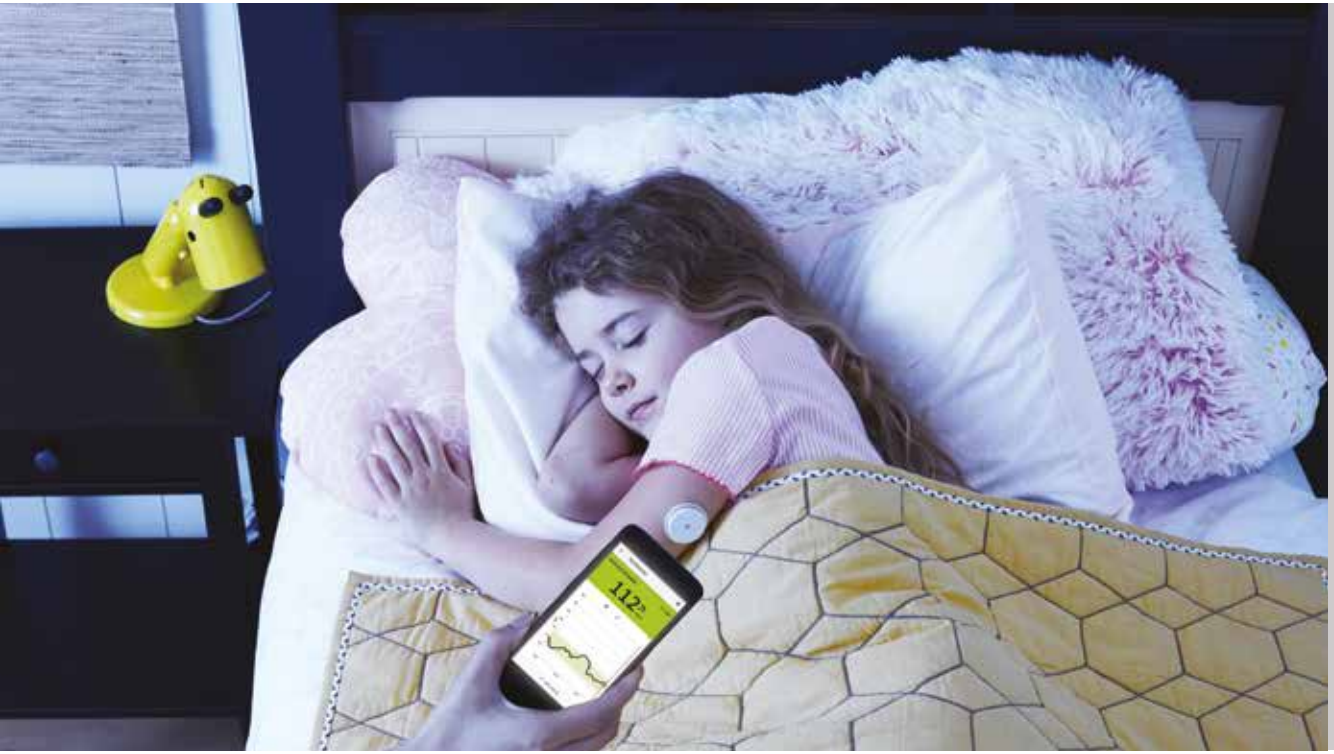

Intervallo di glucosio basso

54-69 mg/dL

90.5%

% entro ±20 mg/dl

L'app FreeStyle LibreLink è uno strumento di supporto per prendere decisioni terapeutiche, senza la necessità di confermare le letture tramite puntura del dito anche in caso di glucosio basso o in diminuzione[2]

FreeStyle LibreLink

Tutti i valori vs. Yellow Springs Instruments (YSI)

[1] Dati in archivio, Abbott Diabetes Care, Inc.

[2] Il test tramite puntura del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi.

Non è necessario ricorrere alle punture del dito:[1]

Senza puntura del dito per confermare il dosaggio dell'insulina - anche quando il glucosio è basso, in calo o in rapida evoluzione[1]

Per il dosaggio dell'insulina	✓
Per confermare un'ipoglicemia o un'ipoglicemia imminente	✓
Quando i livelli di glucosio variano rapidamente	✓
Dopo assunzione di paracetamolo	✓
Per la calibrazione	✓

FreeStyle LibreLink

[1] Il test tramite puntura del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi.

Il sistema FreeStyle Libre
è il sistema di monitoraggio
del glucosio basato su sensore
più utilizzato al mondo[1]

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

I pazienti possono scaricare gratuitamente l'ultima versione dell'app per avere, grazie all'ultimo aggiornamento, l'accuratezza migliore di sempre del sistema FreeStyle Libre.

Accuratezza migliore di sempre, grazie all'ultimo aggiornamento del sistema, nel range glicemico basso e complessiva[3,4]

Senza puntura del dito[2]

Facile da usare

FreeStyle LibreLink

life. to the fullest.

Abbott

[1] Dati in archivio, Abbott Diabetes Care, Inc. Dati basati sul numero di utilizzatori del sistema FreeStyle Libre a livello mondiale rispetto al numero di utilizzatori di altri principali sistemi di monitoraggio del glucosio basati su sensore ad uso personale. [2] Il test tramite puntura del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi. [3] Scheda dati prestazioni sistema FreeStyle Libre. [4] Dati in archivio, Abbott Diabetes Care, Inc.

Per training, aggiornamenti e informazioni
sul mondo FreeStyleLibre visita il sito **www.LibreTraining.it**

I tuoi pazienti possono:
Ottenere maggiori informazioni sul sistema FreeStyle Libre **sul sito www.FreeStyleLibre.it**
Contattare il servizio clienti per assistenza tecnico-addestrativa al **Numero Verde 800-334216**
Seguire la nostra pagina Facebok informativa **Abbott FreeStyle**

FreeStyle LibreLink

life. ***to the fullest.***

Abbott

Immagini unicamente a scopo illustrativo. Non rappresentano pazienti reali. FreeStyle Libre e FreeStyle LibreLink sono dispositivi medici CE2797. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
La forma circolare del dispositivo sensore, FreeStyle, Libre e i marchi correlati sono di proprietà di Abbott © 2020 Abbott ADC 27016 v1
Materiale ad uso esclusivo di operatori sanitari. Non per diffusione al pubblico.